



KUJMXOPYMT3H



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 142265/2023

Sp. zn.:

S-JMK 124661/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet stran:

5

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

25. 09. 2023

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – centrum přirozeného porodu – dodávka zdravotnické techniky

Vysvětlení zadávací dokumentace I

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 20. 09. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/I:

V Technické specifikaci (příloha D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03) v položce 141130 - monitor základních životních fcí pro novorozence na řádce č. 15 zadavatel uvádí: grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kdy uchazeč nabídne grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 72 hodin?

Odpověď č. 1/I:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 2/I:

V Technické specifikaci (příloha D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03) v položce 141130 - monitor základních životních fcí pro novorozence na řádce č. 28 zadavatel uvádí: možnost transportu

monitoru - tzn. napájení na baterii o kapacitě minimálně 2 hodiny provozu s možností rozšíření až na 8 hodin.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kdy uchazeč nabídne napájení na baterii o kapacitě 3,5 hodiny provozu u monitoru vitálních funkcí a 5 hodin provozu u multiparametrického modulu s obrazovkou?

Odpověď č. 2/I:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 3/I:

V Technické specifikaci (příloha D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03) v položce 141130 - monitor základních životních fcí pro novorozence na řádce č. 33 zadavatel uvádí: součástí dodávky dokovací stanice, která bude pevně umístěna na polici, popř. tyči, dokovací stanice napájí monitor a umožňující jeho rychlé uvolnění a použití pro transport bez odpojování kabelů.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kdy uchazeč nabídne dokovací stanice, která bude pevně umístěna na polici, popř. tyči, kdy dokovací stanice napájí multiparametrický modul s obrazovkou a umožňuje jeho rychlé uvolnění a použití pro transport bez odpojování kabelů

Odpověď č. 3/I:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 4/I:

V Technické specifikaci (příloha D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03) v položce 141130 - monitor základních životních fcí pro novorozence na řádce č. 34 zadavatel uvádí: speciální software pro novorozence oxi-kardio-respirogram umožňující definovat důležité fyziologické události obsahující údaje až ze čtyř parametrů, včetně pulzové frekvence, SpO2 (místa před a za duktem), frekvence dýchání, EtCO2, TcpCO2 a TcpO2, umožňující sledovat jejich trendy a dokumentovat je.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, kdy uchazeč nabídne měření TcpCO2 a TcpO2 externím přístrojem, včetně přenosu dat z tohoto externího přístroje na monitor vitálních funkcí?

Odpověď č. 4/I:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 5/I:

V rámci technické specifikace uvedené v příloze D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03 list „SO 03 šestinedělí“ je u položky 401011 matrace pro lůžko uveden technický popis matrace, která popisuje výrobky, které se již nevyrábějí a nejsou dostupné. Rádi bychom nabídli jeden z nástupnických modelů těchto matrací.

Bude zadavatelem akceptována i níže popisovaná matrace, která je dodávána nejvýznamnějším českým výrobcem nemocničních lůžek (a zároveň matrací), která je zcela vhodná pro daný medicínský účel a disponuje parametry

- pasivní antidekubitní matrace – riziko medium
- materiál: horní vrstva - studená pěna o hustotě 50 kg/m², výška 5 cm, spodní vrstva - polyetherová pěna o hustotě 41 kg/m², výška 9 cm
- potah snadno snímatelný – přístupný ze 180° s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 5)
- na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
- rozměr 200 x 86,5 x 14 cm

Odpověď č. 5/I:

Zadavatel bude akceptovat i níže uvedenou specifikaci položky 401011 matrace pro lůžko: pasivní antidekubitní matrace - riziko medium
materiál: horní vrstva - studená pěna o hustotě 50 kg/m², výška 5 cm, spodní vrstva - polyetherová pěna o hustotě 41 kg/m², výška 9 cm
potah snadno snímatelný, přístupný ze 180° s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný,
spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 5)
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
orientační rozměry 200 x 86,5 x 14 cm.

Dotaz č. 6/I:

V rámci technické specifikace uvedené v příloze D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03 list „SO 03 šestinedělí“ je u položky 107105 přístroj ultrazvukový (sono kyčlí) požadován přístroj, v jehož popisu je uveden požadavek na "vysouvatelná mechanická textová klávesnice". Námi dodávaný a nabízený přístroj, splňuje veškeré ostatní požadavky na přístroj avšak disponuje obdobným technickým řešením klávesnice, která je umístěna v praktické poloze přímo na ovládacím panelu a je tak dostupná bez nutnosti jejího mechanického vysouvání či jakékoliv jiné manipulace. Tato drobná odlišnost nemá vliv na medicínská účel.

Bude zadavatelem akceptována nabídka na ultrazvukový přístroj, který splňuje veškeré požadavky a disponuje výše popsáním obdobným technickým řešením klávesnice?

Odpověď č. 6/I:

Zadavatel rozšiřuje specifikaci lineární sondy, tzn., že klávesnice může být umístěna i přímo na ovládacím panelu (dostupnost bez nutnosti jejího mechanického vysouvání či jakékoliv jiné manipulace).

Dotaz č. 7/I:

V rámci technické specifikace uvedené v příloze D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03 list „SO 03 šestinedělí“ je u položky 107105 přístroj ultrazvukový (sono kyčlí) požadován přístroj, v jehož popisu je uveden požadavek na "Lineární sonda pro MSK aplikace o rozsahu min. 7 – 14 MHz".

Námi nabízený přístroj umožňuje připojení a používání lineární sondy pro MSK aplikace o větším rozsahu 4-13MHz. Konstatujeme, že tento rozsah je vhodný a ve větší rozsahu, než je zadavatelem požadováno.

Bude zadavatelem akceptována nabídka výše uvedené lineární sondy pro MSK aplikace?

Odpověď č. 7/I:

Zadavatel rozšiřuje specifikaci lineární sondy, tzn., že rozsah lineární sondy může být i v rozsahu 4-13MHz.

Dotaz č. 8/I:

Zadavatelem je v rámci technické specifikace uvedené v příloze D.1.02.5-006 Specifikace - TECH SO02 požadována položka „175050 systém závěsný s míčem a s porodní stoličkou (např. Combitrack)“ Technické parametry popisují závěsný systém, který odpovídá min. dvou možným provedením. Vyobrazení přikládáme níže.



A)



B)

Provedení B) disponuje navíc opěradlem pro rodičku, které je součástí závěsného systému a dle našeho názoru je pro použití vhodnější.


Mohl by zadavatel specifikovat zda požaduje provedení A) nebo B)?

Odpověď č. 8/I:

Zadavatel požaduje provedení závěsného systému s opěradlem pro rodičku (vyobrazení B).

Dotaz č. 9/I:

Zadavatelem je v rámci technické specifikace uvedené v příloze D.1.02.5-006 Specifikace - TECH SO02 požadována položka „175050 systém závěsný s míčem a s porodní stoličkou (např. Combitrack)“ V technické popisu jsou uvedeny požadavky na A) podložka na nohy B) podložka pod nohy. Rádi bychom se ujistili, co je pod těmito požadavky myšleno. Na dvou obrázcích níže je očíslované příslušenství. Je jako A) podložka na nohy myšlena samostatná židlička pod číslem „10“ a jako B) podložka pod nohy myšlena podložka pod číslem „5“? Nebo je zadavatelem myšleno A)=6 B)=5? Prosíme o upřesnění.

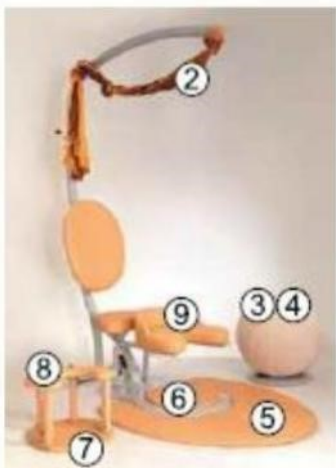

Odpověď č. 9/I:

Zadavatel se vyjadřuje k zaslanému obrázku - Podložka na nohy (samostatná stolička, podnož) - obrázek číslo 10.

Podložka pod nohy - obrázek číslo 5.

Dotaz č. 10/I:

Zadavatel požaduje v souborech D.1.01.5-006 Specifikace - TECH SO01, D.1.02.5-006 Specifikace - TECH SO02 i D.1.03.5-006 Specifikace - TECH SO03 položku „502411 PC vč. monitoru vč. přísl. (klávesnice, myš)“

V popisu této položky je uvedena řada parametrů, ke kterým zasíláme dotazy níže.

A) Je možné dodat značková PC namísto sestavy na míru složenou z jednotlivých komponent?

Značková PC (např. DELL, HP) se mohou v některých detailech odlišovat např. není možno specifikovat velikost zdroje, přesnou velikost chassis a interní kabeláž, chipset atp. Nicméně zákazník získá otestovanou sestavu splňující požadované výkonové parametry (CPU aktuální generace splňující nebo lepší jak požadované PassMark score, RAM, HDD) ostatními parametry se výrazně neodchýlíme od zadání (rozměry skříně). Značkové sestavy se vyznačují kvalitnější podporou od výrobce, možnost standardizovat vybavení bez odchylek podle aktuální nabídky a next-business-day on-site servisem. Tento standard je osvědčený ve všech námi dodávaných medicínských projektech.

B) Některé požadavky konfigurace jsou zastaralé a v kontextu celé konfigurace a periférií bezpředmětné. Lze dodat sestavu bez jejich splnění a místo nich dodat sestavu s aktuálními technologickými standardy?

- Porty PS2 (standardem je již mnoho let port USB a i originální příslušenství je pouze USB)
- Port D-SUB a DVI, pomocí redukce lze všechny legacy porty získat z Display Port

C) Požadavek: Záruka 3 roky, možnost výměny komponent v režii nemocničního IT.

Značková PC obsahují komplexní záruku s výměnou komponent výrobcem na místě pomocí techniků výrobce. Výrobce je některé komponenty jako HDD a RAM ochoten při řešení reklamace zaslat k výměně ve vlastní režii. Nicméně zásadnější komponenty si nemůže majitel měnit sám vzhledem k nutné garanci a určení zodpovědnosti za vady.

Závěrem. Shrnující dotaz: Bude pro položku „502411 PC vč. monitoru vč. přísl. (klávesnice, myš)“ umožněno učinit nabídku značkové PC sestavy dle argumentů výše uvedených a dle aktuálních technologických možností a standardů pro PC - tzn. v modernější konfiguraci, než je požadováno, se zárukou od výrobce v délce 3 roky, namísto sestavy na míru složenou z jednotlivých komponent a před samotným dodáním bude PC sestava podléhat schválení ze strany zadavatele?

Odpověď č. 10/I:

Položka č. 502411 - PC vč. monitoru vč. přísl. (klávesnice, myš) – není součástí výpisu prvků, není tedy součástí dodávky.

V návaznosti na výše uvedenou úpravu zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby dodavatelé měli dostatek času na zpracování provedených úprav do svých nabídek. Nově tedy lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 10. 2023 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru