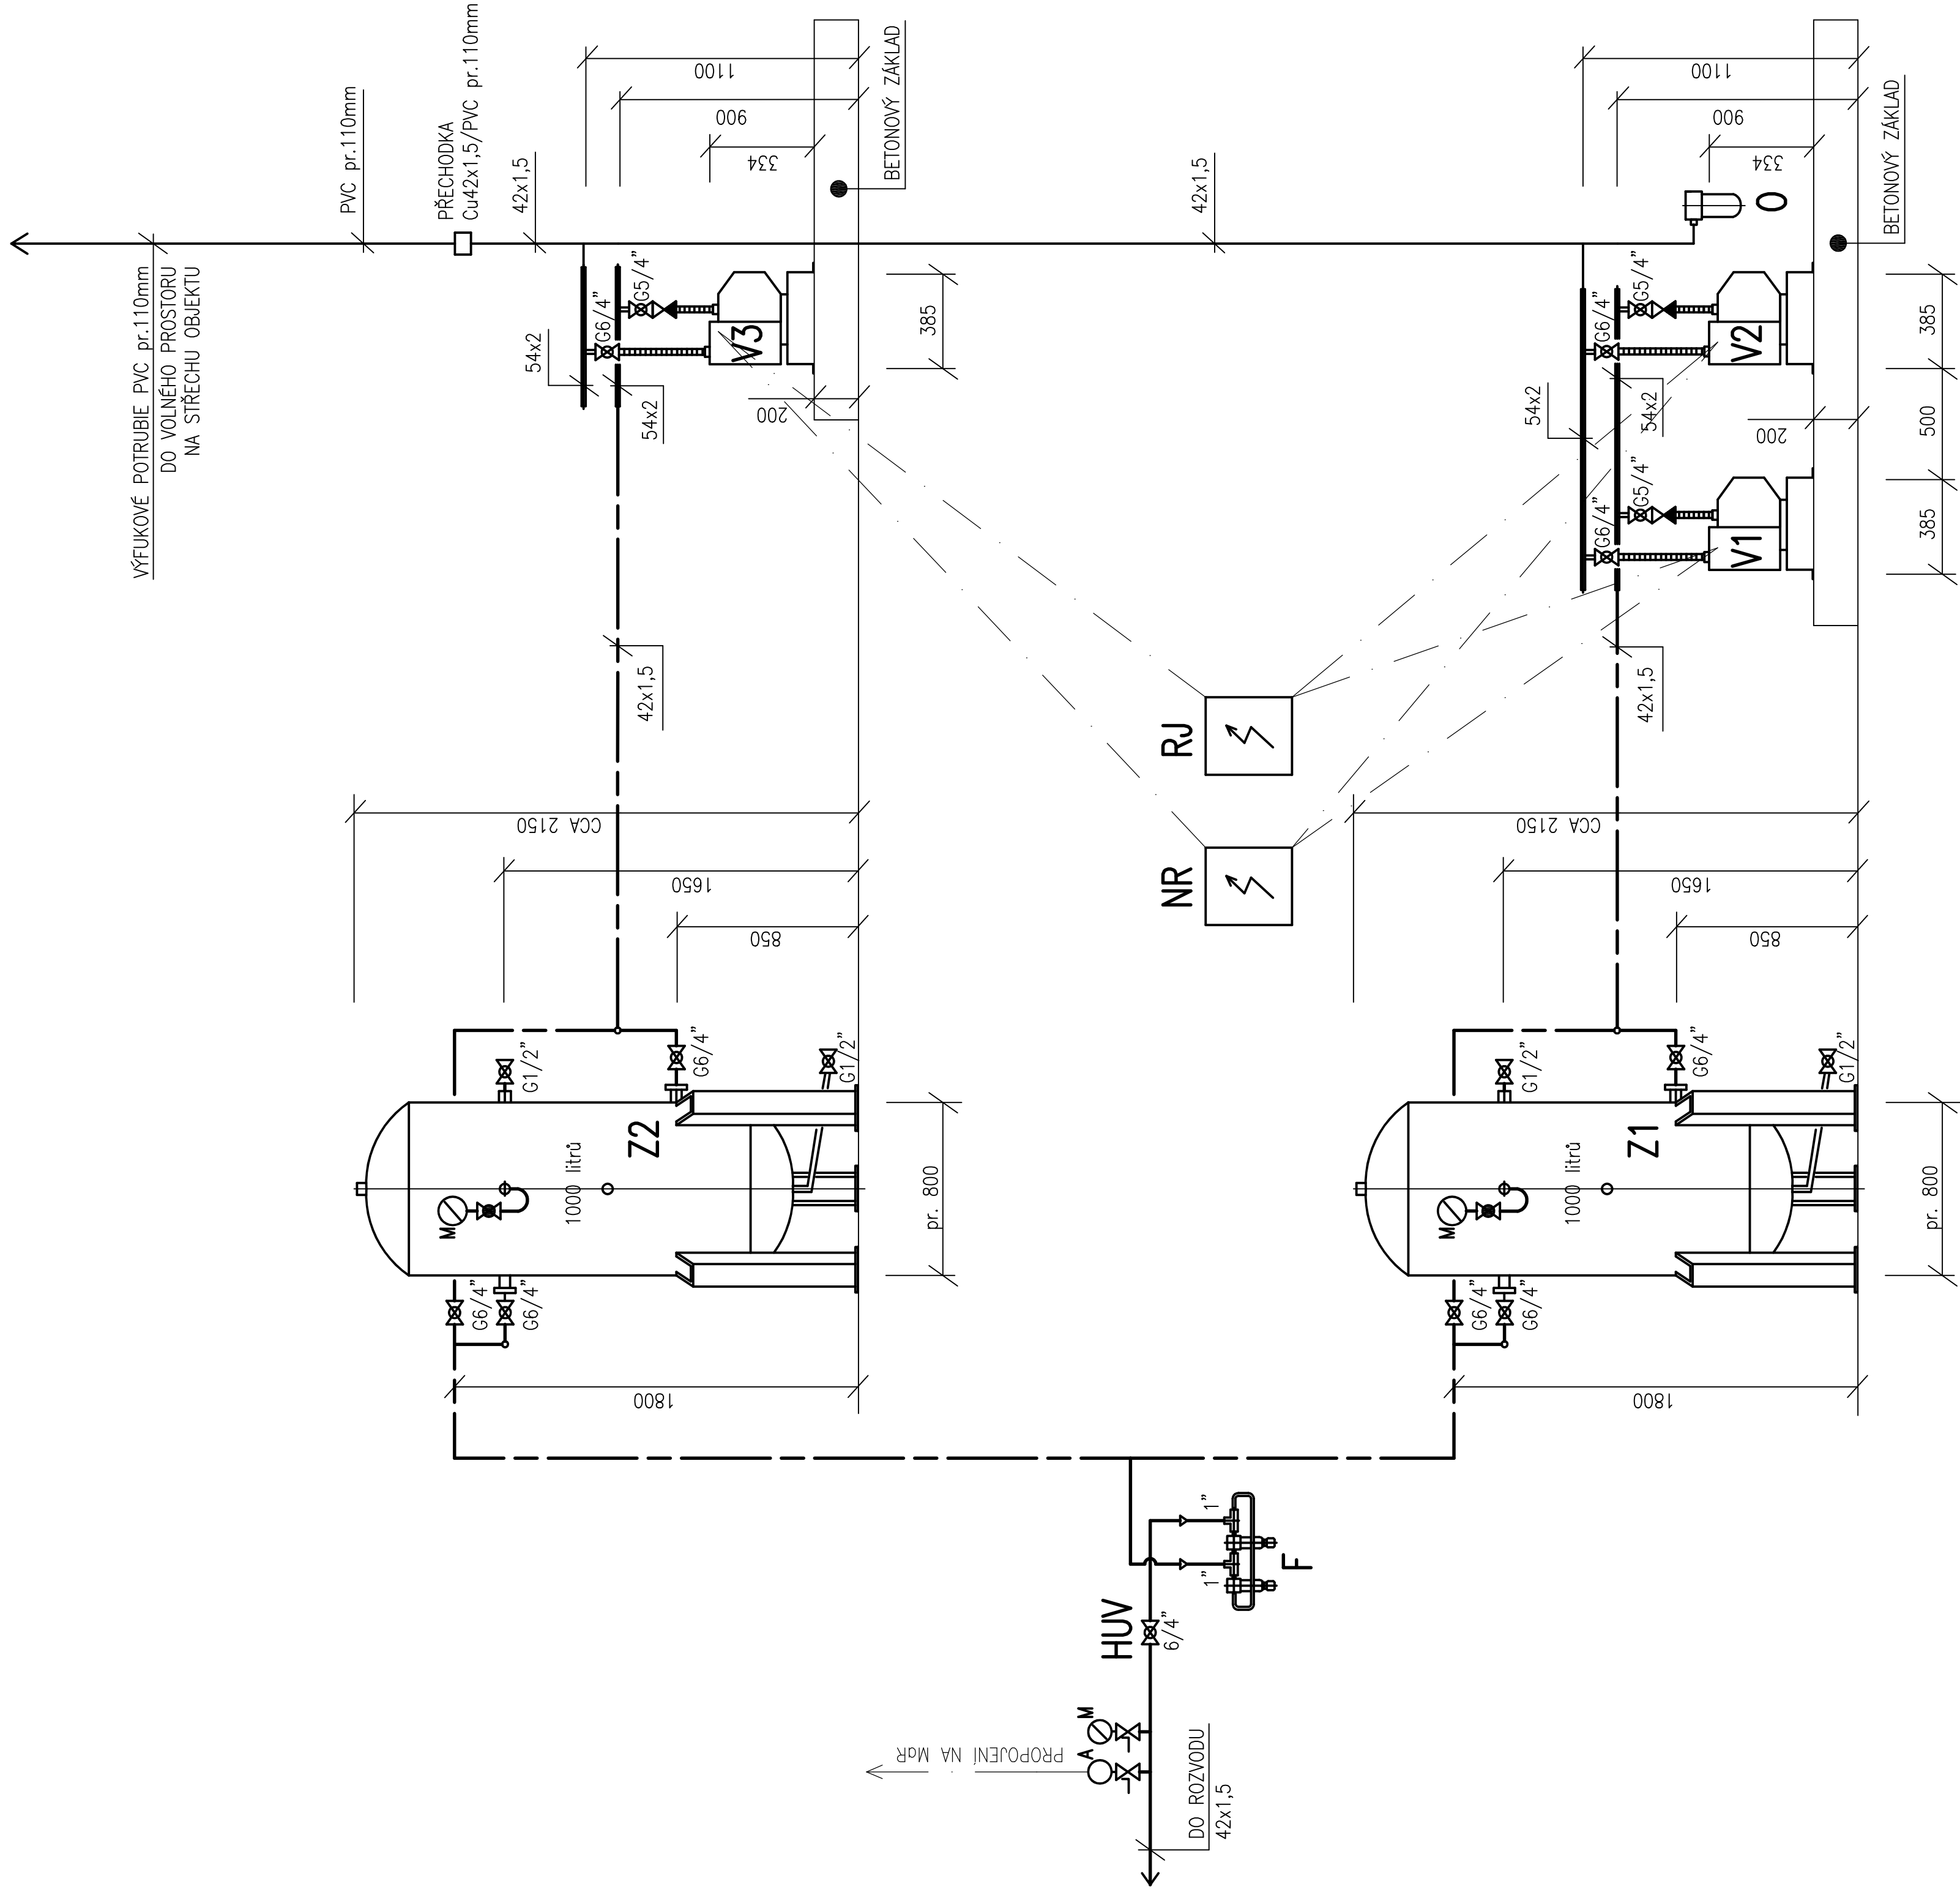










SCHÉMA PODTLAKOVÉ STANICE

MĚŘÍTKO: NENÍ



LEGENDA PODTLAKOVÉ STANICE	
NR	NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍVODNÍ KABEL
RJ	ŘÍZENÍ PRO 3 VÝVĚVY
HUV	HLAVNÍ UZAVÍRAČÍ VENTIL
O	ODLUČOVAČ – ZACHYTCENÍ KONDENZÁTU VODNÍCH PAR
F	ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTRACE DUPLEX
Z1, Z2	STOJATÝ ZÁSOBNIK PODTLAKU, objem 1000 litrů
V1, V2, V3	VÝVĚVA 2,2 kW, 100 Nm ³ /h
QA	ČIDLO NOUZOVÉHO PROVOZNIHO ALARMU
QM	VAKUOMETR KONTROLNÍ
	VENTIL UZAVÍRAČÍ LAHOVÝ
	ZPĚTNÝ VENTIL
	KULOVÝ UZÁVĚR
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
	POTRUBÍ PODTLAKU

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ JE MĚNĚNÉ VEDENÉ NA KONZOLÁCH.
UZAVÍRACÍ ARMATURY TVOŘÍ KULOVÉ UZÁVĚRY.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
<div> <div>  <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍHO INŽENÝRSTVÍ</p> </div> <div> <p>Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Svátozáveská 1247/22 097 02 Kyjov</p> </div> </div>			
<p>Investor: NEMOČNICE KYJOV, p.o. Svátozáveská 1247/22 097 02 Kyjov</p>			Datum
<p>Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Svátozáveská 1247/22 097 02 Kyjov</p>			Datum
<p>Vedoucí projektant zakázky: ING. IVO PRUCHA</p>			Datum
<p>Profese:</p>			<p>Autorizace:</p>
<p>Zpracoval dle:</p>			<p>Fare:</p>
<p>Ing. Zdeněk Kvapil Liberec Tel. +420 602 287 810 E-mail: i.kvapil@seznam.cz</p>			<p>20 - 2023</p>
<p>MED</p>			<p>08 - 2023</p>
<p>Vypracoval:</p>			<p>DSP + DPS</p>
<p>Odpovědný projektant:</p>			<p>Stupeň</p>
<p>ING. ZDENEK KVAPIL</p>			<p>Formát</p>
<p>Ing. Zdeněk Kvapil</p>			<p>6 A4</p>
<p>Objekt:</p>			<p>Měřítka:</p>
<p>PODLAKOVÉ STANICE V PAVILONU E</p>			<p>-</p>
<p>Obsah:</p>			<p>D.1.01.4e-102</p>
<p>SKÉMA PODTLAKOVÉ STANICE</p>			<p>D.1.01.4e-102</p>