

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“
nebo „ZZVZ“)****1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
IČO:	00839205
Statutární zástupce zadavatele:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení

3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel uveřejnil dle § 96 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 22.06.2023

Hodina: 10:00 h.

5. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. Po podání nabídek do předmětného zadávacího řízení bude veškerá komunikace zadavatele s dodavateli probíhat proto prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) dostupného na URL adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

Nabídka musí být podána v českém nebo slovenském jazyce.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

6.1. Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) Zákona.

6.2. Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením:

- **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Nebo obdobné, pokrývající předmět plnění této veřejné zakázky

6.3. Technická kvalifikace:

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením **seznamu významných dodávek** poskytnutých účastníkem **za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele**. V seznamu významných dodávek bude dále uvedena, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření.

V seznamu významných dodávek účastník doloží poskytnutí **alespoň 2 zakázek s obdobným předmětem plnění**.

Zadavatel stanovil, že dodávkou s obdobným předmětem plnění je dodávka a montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru ve finančním objemu každé z uvedených významných dodávek min. 1 200 000,- Kč bez DPH.

6.4. Informace k prokázání kvalifikace:

Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník je oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona. Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Pokud vybraný dodavatel nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

6.5. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 82 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) zákona samostatně a v plném rozsahu.

6.6. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci - systém e-Certis § 86 odst. 1 zákona

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

Prokazování kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

Kvalifikaci může účastník zadávacího řízení prokázat v souladu s § 87 zákona Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

6.7. Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny v kvalifikaci

Dojde-li po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené ve Formuláři nabídky – tabulka hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících, zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace účastníků.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V souladu s ustanovením § 37 zákona, stanovil zadavatel podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení, které jsou uvedeny v jednotlivých svazcích zadávací dokumentace. Tyto podmínky vymezují charakteristiky a požadavky dodavatele předmětné zakázky (podmínky kvalifikace), obchodní podmínky a technické parametry a požadavky na plnění, které je předmětem veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace obsahuje:

- | | |
|--|-------------|
| • Podmínky zadávacího řízení | Svazek č. 1 |
| • Formulář nabídky | Svazek č. 2 |
| • Obchodní podmínky | Svazek č. 3 |
| • Požadované technické parametry přístroje | Svazek č. 4 |
| • Schéma prostoru umístění stávajících sterilizátorů a ostatní parametry | Svazek č. 5 |
| • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) | |

Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

Ve Vyškově dne

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p.o.

PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**veřejné zakázky na dodávky zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo
„ZZVZ“)**

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory

I. Údaje o zahájení zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory (dále také zakázka).
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka.
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

II. Údaje o zadavateli

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátcem DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889
Kontaktní osoba: Milan Pavlun

Tel: 603 251 031
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz

Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace

PAVLUN s.r.o. zastoupená Milanem Pavlunem
Tel: 603 251 031
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo: Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli se řídí příslušnými ustanoveními § 211 zákona. Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. Po podání nabídek do předmětného zadávacího řízení bude veškerá komunikace zadavatele s dodavateli probíhat

proto prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) dostupného na URL adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny zadávací podmínky dle ust. § 36 zákona, kterým zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace obsahuje doplňující informace a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány, a jejich nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníka o veřejnou zakázku závazná.

Zadávací dokumentace obsahuje:

- Podmínky zadávacího řízení Svazek č. 1
 - Formulář nabídky Svazek č. 2
 - Obchodní podmínky Svazek č. 3
 - Požadované technické parametry přístroje Svazek č. 4
 - Schéma prostoru umístění stávajících sterilizátorů a ostatní parametry Svazek č. 5
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány)

Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

Obsah podmínek zadávacího řízení

1. Předmět veřejné zakázky	3
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
3. Jistota.....	3
4. Požadavky na varianty nabídky	3
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	3
6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny	4
6.1. Obchodní podmínky.....	4
6.2. Platební podmínky	4
7. Doba plnění veřejné zakázky	4
8. Místo plnění veřejné zakázky	4
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.....	4
10. Způsob hodnocení nabídek	4
11. Další požadavky na zpracování nabídky.....	5
12. Přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace	5
13. Prohlídka místa plnění	5
14. Forma podání nabídky, podání nabídky	5
15. Otevírání nabídek	6
16. Zadávací lhůta	6
17. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky	6
18. Ostatní ujednání	6
19. Ochrana osobních údajů.....	6

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodat a zadavateli předat nové, nerepasované, dosud neužívané, plně funkční, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží, spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání a užívání zboží: 2ks sterilizátorů parních prokládacích s veškerým potřebným a nezbytným příslušenstvím (dále také jen jako „sterilizátory“) v tomto členění.

Položka č.	Předmět plnění	Počet ks
1	Demontáž a likvidace stávajících sterilizátorů	2
2	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1
3	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1
4	Zaškolení obsluhy parního sterilizátoru	2
5	Úprava otvorů pro nové přístroje – požadujeme designově stejné provedení se stávajícím tzn. v případě menších rozměrů doplnění obdobným nerezovým materiálem, eventuálně v případě větších rozměrů úpravu stávajícího provedení	1

Součástí plnění je také poskytování záručního servisu a garance pozáručního servisu. Součástí plnění jsou i veškeré doklady nutné k řádnému převzetí a užívání sterilizátorů, včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.

Součástí předmětu zakázky je také:

- demontáž stávajících přístrojů – 2 ks sterilizátorů, odvoz a ekologická likvidace,
- úprava otvorů pro nové přístroje (dle svazku č. 5 - Dispoziční schéma prostoru umístění stávajících sterilizátorů),
- doprava a dodání Předmětu plnění na místo plnění a jeho vybalení, instalace, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a zprovoznění v místě plnění,
- služby spočívající v instalaci zboží zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Připravenost rozvodů, tj. napojení na zdroje (el. energie, voda, atd.) zajistí zadavatel dle požadavků dodavatele,
- služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží,
- služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu,
- služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného a účinného zákona o zdravotnických prostředcích obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
- předání veškeré dokumentace nutné k převzetí a užívání Předmětu plnění, tj. např.:
 - o technické (uživatelské) dokumentace,

- o dokladů o provedených revizích, instrukcí, záručních (reklamačních) listů, návodů k obsluze a údržbě Předmětu plnění, validační protokol, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce,
- o prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy
- o dokumentace dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích
- o předání certifikátu CE,
- o zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- vypracování a předání celkového detailního sumáře dodaných položek předmětu plnění,
- odvoz a ekologická likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých v rámci předání Předmětu plnění, použité obaly musí být z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, tak aby je bylo možné jednoduše třídit,
- zajištění bezplatného záručního servisu předmětu plnění a garance dostupnosti pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů minimálně po dobu 10ti let po skončení záruční doby,
- min. 1x ročně bezplatná preventivní prohlídka předmětu plnění autorizovaným servisním technikem včetně údržby a použitého spotřebního materiálu k údržbě a náhradních dílů, která se uskuteční na konci záruční doby předmětu plnění v termínu dle vzájemné domluvy smluvních stran,
- obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Bližší specifikace předmětu zakázky a podrobný popis je uvedený ve svazcích č. 3 – č. 5 této zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):

33191000-5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

33191100-6 Sterilizátor

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky je stanovena na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 4 545 455,- Kč bez DPH.

3. Jistota

Zadavatel nepožaduje.

4. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem určeného předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech souvisejících poplatků dodavatele, např. dopravy na místo určení, montáže a zaškolení pracovníků, balné a dopravné do místa plnění, cla, sestavení, případné zapojení a uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců příslušných oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. zpracování potřebných revizních zpráv elektra (po zprovoznění), zpracování návrhu na likvidaci stávajících přístrojů – odborné zdůvodnění.

- 5.1. atd. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně těch, které nejsou zadávací dokumentací výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl, nebo měl a mohl vědět.
- 5.2. Nabídková cena bude v návrhu smlouvy uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč

bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pokud účastník hodlá nabídnout slevu z ceny, musí slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

6.1 Obchodní podmínky

Dodavatel poskytne na dodávku plnou záruku za kvalitu min. 24 měsíců.

Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po tuto dobu plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které má dané zboží nebo výrobek splňovat, a které se na dané zboží a výrobky vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím. Pokud bude předepsáno tuto skutečnost potvrdit odbornou (periodickou) kontrolou, je součástí bezplatné záruky také provedení takové kontroly a předání příslušné dokumentace o kontrole kupujícím.

Kompletní obchodní podmínky jsou podrobně popsány v Kupní smlouvě, která je součástí zadávací dokumentace.

6.2 Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** dní od doručení faktury.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v Kupní smlouvě, která tvoří součást zadávací dokumentace.

7. Doba plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno dnem nabytí účinnosti smlouvy na plnění předmětné zakázky.

Plnění předmětné veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy na plnění předmětné zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

8. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 Vyškov.

9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Po podání nabídek do předmětného zadávacího řízení bude v souladu s ustanovením § 211 zákona probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem elektronicky.

10. Způsob hodnocení nabídek

10.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH uvedená ve Formuláři nabídky – tabulka hodnocení. V případě stejné výše nabídkové ceny u více účastníků bude jako nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka:

- Losem za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

11. Další požadavky na zpracování nabídky

11.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

11.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

11.3. Součástí nabídky musí být:

- 11.3.1. Vyplněný Formulář nabídky (svazek č. 2), jehož vzor je součástí zadávací dokumentace.
- 11.3.2. Přílohy závazného návrhu Kupní smlouvy (svazek č. 3 ZD), které musí být vyplněné účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace a podepsané osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a to:
 - 11.3.2.1. Příloha č. 1 Technické parametry požadovaného zařízení (Vyplněný svazek č. 4 ZD).
 - 11.3.2.2. Příloha č. 2 Předávací protokol.
 - 11.3.2.3. Příloha č. 3 Protokol o instruktáži obsluhy.
 - 11.3.2.4. Příloha č. 4 Přehled doporučených pravidelných servisních činností a jejich četnost (účastník zpracuje přehled stanovených pravidelných servisních činností po dobu životního cyklu parních sterilizátorů).
 - 11.3.2.5. Příloha č. 5 Harmonogram postupu dodávky
- 11.3.3. Návod k obsluze pro dodávané zařízení. Návod k obsluze musí být v českém jazyce v poslední platné verzi.
- 11.3.4. Technický instalační výkres výrobce nabízeného zařízení, umožňující kontrolu celkových rozměrů jednotlivých částí.
- 11.3.5. Technický – katalogový list výrobce nabízeného zařízení pro kontrolu a ověření jednotlivých provozních hodnot, výkonů.
- 11.3.6. Prohlášení výrobce o autorizaci účastníka na dodávku a servis nabízeného zařízení, pokud účastník není sám výrobcem.
- 11.4. Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém nebo slovenském jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém nebo slovenském, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
- 11.5. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal na předmětnou veřejnou zakázku více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12. Přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace

- 12.1. Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html.
- 12.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (elektronický nástroj E-ZAK) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 12.3. Vysvětlení, včetně přesného znění dotazu a odpovědi Zadavatele, budou zveřejněny na Profilu Zadavatele na internetové adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html.

13. Prohlídka místa plnění

Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 16.6.2023 ve 13:00. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před vjízdou (hlavní vstup pro pěší i vozidla) do areálu Nemocnice Vyškov (Purkyňova 235/36, Nosálovice 68201 Vyškov).

14. Forma podání nabídky, podání nabídky

- 14.1. Nabídky mohou být podávány jen elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 14.2. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a končí dne 22.6.2023 v 10:00 h.
- 14.3. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce: <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- 14.4. Zadavatel upozorňuje účastníky na povinnost pravidelných kontrol profilu zadavatele

pro případné získání vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil, poskytl či předal zadávací dokumentaci.

- 14.5. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu FEN.cz.

15. Otevírání nabídek v elektronické podobě

- 15.1. Zadavatel zahájí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání nabídek v elektronické podobě zpřístupněním jejího obsahu zadavateli.
- 15.2. Otevírání nabídek v elektronické formě proběhne v souladu s § 109 zákona a je neveřejné.

16. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, stanoví zadavatel ve smyslu § 40 odst. 1 zákona na 120 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

17. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky

- 17.1. Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 17.2. Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě. *(Poznámka: U dokumentů, které má účastník pouze v listinné podobě, je nutné učinit převedení těchto listinných dokumentů do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).*

18. Ostatní ujednání

- 18.1. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- 18.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 zákona.
- 18.3. Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.
- 18.4. Ochrana informací: Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Za důvěrné informace nelze označit údaje, které má zadavatel povinnost zveřejňovat podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

19. Ochrana osobních údajů

- 19.1. V souvislosti se zadávacím řízením získává zadavatel od účastníků zadávacího řízení kontaktní údaje jejich zaměstnanců, případně dalších pověřených osob a dále osobní údaje k

prokázání kvalifikace dle požadavků stanovených v zákoně potažmo v této zadávací dokumentaci. Subjekty údajů jsou v tomto případě zaměstnanci dodavatelů či poddodavatelů, jiné kontaktní osoby (např. jednatele), fyzické podnikající osoby v postavení dodavatele či poddodavatele a dále osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci.

- 19.2. V souladu s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), plní tímto zadavatel jakožto příjemce a správce takto získaných osobních údajů svou povinnost informovat tyto subjekty údajů, jak je uvedeno dále.
- 19.3. Zadavatel zpracovává osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů za účelem zajištění kontaktů mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení, dále za účelem provedení hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) Nařízení. V případě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívá oprávněný zájem zadavatele ve výběru nejvýhodnějšího dodavatele pro plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V případě vybraného dodavatele zpracovává zadavatel dále taktéž kontaktní osobní údaje za účelem splnění smlouvy. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje taktéž na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
- 19.4. Osobní údaje uvedené v nabídkách účastníků mohou být předány externím členům hodnotící komise, externím poradcům a administrátorům v rámci hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti a dále orgánům veřejné moci, zejména ÚOHS, z důvodu kontroly průběhu řízení.
- 19.5. Osobní údaje uvedené v nabídkách a získané v průběhu zadávacího řízení jsou zpracovávány po dobu trvání zadávacího řízení a dále po dobu stanovenou v § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje uváděné ve smlouvě s vybraným dodavatelem jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání práv a povinností v souvislosti s touto smlouvou, nejméně po dobu stanovení v § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
- 19.6. Subjekt údajů je oprávněn od zadavatele požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, jejich výmaz dle čl. 17 Nařízení, omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení, dále je oprávněn vznést námitky dle čl. 21 Nařízení v případě zpracování založeném na právním titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a taktéž právo na přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení Nařízení, může podat stížnost dle čl. 77 Nařízení přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 19.7. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dále uvedeny na webových stránkách <http://www.nemvy.cz/gdpr>
- 19.8. Zadavatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat
- 19.9. na e-mail: poverenec@nemvy.cz.
- 19.10. Dodavatel je povinen splnit vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly předány v souvislosti se zadávacím řízením nebo plněním smlouvy s vybraným dodavatelem, svou informační povinnost dle čl. 13 Nařízení a dále jim sdělit výše uvedené informace poskytované zadavatelem dle čl. 14 Nařízení.

Konec: Svazek č. 1 Zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení.

FORMULÁŘ NABÍDKY

Veřejná zakázka: „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“

Účastník doplní formulář pouze v místech příslušných pro doplnění

Účastník:

.....

Zastoupený:

.....

IČO:

.....

Sídlo firmy:

.....

DIČ:

.....

Telefon:

.....

Bankovní spojení:

.....

ID datové schránky:

.....

Číslo účtu:

.....

E-mail:

.....

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Adresa elektronické pošty (e-mail)	
Datová schránka ¹	
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou elektronickou adresu nebo do datové schránky se považuje za doručení účastníkovi zadávacího řízení.

V případě, že nabídku podává více dodavatelů, musí být uvedeny informace o všech dodavatelích včetně doručovací adresy a kontaktní osoby účastníka zadávacího řízení

tímto prohlašuje, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

¹ Údaj o identifikaci datových schránek účastníka zadávacího řízení je nepovinný. Uvede jej pouze účastník, který má zřízenou datovou schránku a který souhlasí se zasíláním informací o zadávacím řízení do svých datových schránek.

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona),
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 1 písm. d) Zákona),
- výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Účastník prohlašuje, že:

splňuje profesní kvalifikaci dle ustanovení § 77 Zákona, což dokládá:

- **výpisem z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeníNebo obdobné, pokrývající předmět plnění této veřejné zakázky

Účastník prohlašuje, že:

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, což dokládá následujícím seznamem významných dodávek (*dodavatel je oprávněn doplnit i další referenční zakázky tak, aby splnil požadavky stanovené zadávacími podmínkami*):

Významná dodávka č. 1: (účastník doplní požadované informace)	
Název zakázky:	
Objednatel:	
Účtované částky za provedené zakázky:	
Stručná charakteristika zakázky (obchodní a typové označení dodávaného sterilizátorů):	
Účtovaná cena v Kč bez DPH za provedenou zakázku:	
Doba poskytnutí od — do:	
Kontaktní osoba objednatele — tel., e-mail:	

Významná dodávka č. 2: (účastník doplní požadované informace)

Název zakázky:	
Objednatel:	
Účtované částky za provedené zakázky:	
Stručná charakteristika zakázky (obchodní a typové označení dodávaného sterilizátorů):	
Účtovaná cena v Kč bez DPH za provedenou zakázku:	
Doba poskytnutí od — do:	
Kontaktní osoba objednatele — tel., e-mail:	

Údaje účastníka zadávacího řízení k hodnoticímu kritériu:

Položka č.	Předmět plnění	Počet ks	j.c. bez DPH	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1	Demontáž a likvidace stávajících sterilizátorů	2		
2	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1		
3	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1		
4	Zaškolení obsluhy parního sterilizátoru	2		
5	Úprava otvorů pro nové přístroje – požadujeme designově stejné provedení se stávajícím tzn. v případě menších rozměrů doplnění obdobným nerezovým materiálem, eventuálně v případě větších rozměrů úpravu stávajícího provedení	1		
Celková výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky				

Nabízené přístroje:

Předmět plnění	Počet ks	Typové označení a obchodní název přístroje
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1	
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1	

Účastník prohlašuje, že:

- akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky uvedenými v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy o dílo a servisní smlouvy.
- Účastník není obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).

- Neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 4b* zákona o střetu zájmů.

(*) Znění § 4b zákona o střetu zájmů: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

- V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, účastník:
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
 - c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- Účastník dále prohlašuje, že splnění výše uvedených podmínek se týká i případných poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s nimi podává společnou nabídku.
- Veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne

.....

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zpracovat do závazného návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek nemůže účastník při zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

Ing. Jaromírem Herzánem – vedoucím obchodního oddělení ve věcech technických

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100

E-mail: horak@nemvy.cz

(dále jen „kupující“)

a

Název

Zastoupený

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, v odd....., vložka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen "prodávající")

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ doplní účastník pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu **nový(é) zdravotnický(é) přístroj(e)** za podmínek stanovených Zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ na dodávku této techniky, dále také označováno „zboží“, nebo „přístroj(e)“, a to:

Předmět plnění	Počet ks	Typové označení a obchodní název přístroje
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1	
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1	

Požadovaná technická specifikace zdravotnického přístroje je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Pokyn pro účastníka:

Dodavatel k návrhu smlouvy přiloženého v nabídce doplní informace o jím nabízeném zboží. Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce přiloží jím vyplněný svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje.

2. Součástí plnění je také:

- Poskytování záručního servisu a garance pozáručního servisu. Součástí plnění jsou i veškeré doklady nutné k řádnému převzetí a užívání sterilizátorů, včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.
- demontáž stávajících přístrojů – 2 ks sterilizátorů, odvoz a ekologická likvidace,
- úprava otvorů pro nové přístroje (dle svazku č. 5 - Schéma prostoru umístění stávajících sterilizátorů a ostatní parametry),
- doprava a dodání Předmětu plnění na místo plnění a jeho vybalení, instalace, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny a zprovoznění v místě plnění,
- služby spočívající v instalaci zboží zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Připravenost rozvodů, tj. napojení na zdroje (el. energie, voda, atd.) zajistí zadavatel dle požadavků dodavatele,
- služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží,
- služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu,
- služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného a účinného zákona o zdravotnických prostředcích obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
- předání veškeré dokumentace nutné k převzetí a užívání Předmětu plnění, tj. např.:
 - o technické (uživatelské) dokumentace,
 - o dokladů o provedených revizích, instrukcí, záručních (reklamačních) listů, návodů k obsluze a údržbě Předmětu plnění, validační protokol, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce,
 - o prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy

- o dokumentace dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích
 - o předání certifikátu CE,
 - o zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
 - vypracování a předání celkového detailního sumáře dodaných položek předmětu plnění,
 - odvoz a ekologická likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých v rámci předání Předmětu plnění, použité obaly musí být z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, tak aby je bylo možné jednoduše třídit,
 - zajištění bezplatného záručního servisu předmětu plnění a garance dostupnosti pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů minimálně po dobu 10ti let po skončení záruční doby,
 - min. 1x ročně bezplatná preventivní prohlídka předmětu plnění autorizovaným servisním technikem včetně údržby a použitého spotřebního materiálu k údržbě a náhradních dílů, která se uskuteční na konci záruční doby předmětu plnění v termínu dle vzájemné domluvy smluvních stran,
 - obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
3. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží včetně jeho příslušenství. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje k provedení jeho odborné instalace a uvedení do provozu, k předvedení jeho chodu, k instruktáži budoucí obsluhy a k předání veškerých dokladů potřebných k jeho převzetí a k jeho řádnému užívání. Kupující se zavazuje dodané zboží společně s veškerou dokumentací vztahující se ke zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu níže specifikovanou kupní cenu.
4. Prodávající prohlašuje, že
- a) zboží je nové a plně funkční. Za nové zboží smluvní strany shodně nepovažují zejména zboží použité, repasované či zboží využívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely (tzv. „demo“ přístroje);
 - b) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (včetně souvisejících příslušných nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
 - c) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE ve smyslu zák. č. 490/2009 Sb., v platném znění, prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující

alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží;

d) garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení;

e) doporučené pravidelné servisní činnosti a jejich četnost dodávaných zdravotnických přístrojů je uvedena v příloze č.4 této smlouvy Přehled doporučených pravidelných servisních činností a jejich četnost

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně prodávaného zboží takto:

Položka č.	Předmět smlouvy	Počet ks	J.c. bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Demontáž a likvidace stávajících sterilizátorů	2		
2	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1		
3	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1		
4	Zaškolení obsluhy parního sterilizátoru	2		
5	Úprava otvorů pro nové přístroje – požadujeme designově stejné provedení se stávajícím tzn. v případě menších rozměrů doplnění obdobným nerezovým materiálem, eventuálně v případě větších rozměrů úpravu stávajícího provedení	1		
Cena celkem za celý předmět smlouvy v Kč bez DPH				
Cena celkem za celý předmět smlouvy v Kč včetně DPH				

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ doplní účastník jím nabízenou kupní cenu za předmět smlouvy.

2. V kupní ceně zboží je zahrnuto:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti,
- instalace a zapojení zboží jeho uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, zkušebního provozu, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáže zaměstnanců kupujícího aplikačním odborníkem pro plné uživatelské užívání zboží.
- provádění pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, výměny náplní, prvků, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD nebo USB flash disku,
- dodání prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,

- dodání prohlášení o třídě míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, dle § 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provedení instruktáže obsluhy a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy ve třech originálních vyhotoveních.
- předložení dokladu o likvidaci obalů a odpadu,

3. Výše uvedená kupní cena za zboží bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného prodávajícím a doručené kupujícím. Fakturu - daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu ke zboží.

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu bude splněn řádně a včas připsáním částky odpovídající kupní ceně ve lhůtě splatnosti na účet uvedený na příslušné faktuře.

5. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy, a zejména tyto údaje:

- název zboží,
- označení banky a číslo účtu prodávajícího,
- označení předmětu koupě,
- cenu každé měrné jednotky,
- cenu bez DPH, DPH a včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním kupujícího podle tohoto odstavce není kupující v prodlení.

6. Nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu řádně a včas, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

III.

Doba, místo a způsob dodání

1. Zboží bude prodávajícím dodáno na adresu sídla kupujícího, Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace, a to nejpozději do 140 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Za dodání zboží se považuje jeho předání na výše uvedené adrese, jeho instalace a uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání, instruktáž budoucí obsluhy a následný podpis předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

3. Kupující se zavazuje, že vytvoří podmínky pro instalaci zboží bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, že je připraven zboží dodat.

4. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení tel: č. 517 315 149. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.

5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady.
6. Součástí plnění dle čl. I. této smlouvy je i provedení instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců oddělení, zaměstnance Obchodního oddělení Kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle příslušných ustanovení zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a včetně doložení pověření školitele výrobcem.
7. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepíší a podepíší při dodání předávací protokol dle přílohy č. 2 této smlouvy. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více jak 30 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy, přičemž právo na náhradu škody není tímto postupem kupujícího dotčeno.
9. Zboží bude předáno a převzato na základě Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V předávacím protokolu musí být uvedeny zvlášť jednotlivé komponenty dodaných zařízení, materiály apod.
10. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat primář příslušného oddělení a zaměstnanec obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, p. o. Jedná se o pracovníky pro tento právní úkon pověřené statutárním orgánem kupujícího.
11. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.
12. Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.
13. V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.
14. Prodávající se zavazuje dodávku realizovat v souladu s harmonogramem postupu dodávky, který tvoří přílohu č.5 této smlouvy.

IV.

Odpovědnost za vady, záruční ujednání

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a příslušnými platnými právními předpisy i technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak v zemi původu zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží. Záruční doba je 24 měsíců, není-li v této smlouvě uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dodání zboží. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku vady či poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce záruční doby.
4. Součástí záruky je:
- provádění instruktáže obsluhy (u nových pracovníků kupujícího) a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy po celou dobu záruční doby.
 - provádění plánované servisní údržby zařízení v intervalech podle doporučení výrobce,
 - nastavení zařízení a kontrola provozních parametrů na základě doporučení výrobce a podle předpisů a legislativy pro zdravotnické prostředky,
 - provádění servisních zásahů při poruše zařízení na základě výzvy,
 - bezplatné dodání potřebných náhradních dílů a potřebného spotřebního materiálu, náplní a prvků. Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován,
 - provádění preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., v platném znění; zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla v termínech stanovených výrobcem přístroje. Poslední periodická prohlídka však bude provedena alespoň 14 dnů před termínem ukončení záruční doby.
5. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bude nesprávná funkce nebo poškození zboží prokazatelně způsobeno nevhodnými nebo modifikovanými spotřebními materiály a pracovními postupy, nesprávnou obsluhou nebo vyšší mocí.
6. Během trvání záruční doby poskytnuté na dodané zboží se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis včetně náhradních dílů a provádění pravidelných preventivních prohlídek v intervalech předepsaných výrobcem. Proávající prohlašuje, že je způsobilý zajistit provádění periodických bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
7. Proávající se zavazuje nastoupit k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od oznámení poruchy kupujícím (např. telefonicky, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy kupujícím bez potřeby náhradního dílu (ND), v případě nutnosti ND do pěti dnů. Nepodaří-li se prodávajícímu uvést zboží do provozu v uvedené lhůtě 48 hodin, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu zapůjčit kupujícímu náhradní zboží srovnatelných parametrů, jež bude plnit stejný účel a funkce jako dodané zboží. Bude-li vada shledána jako neodstranitelná, poskytne prodávající kupujícímu bezplatně náhradní zboží a převede vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. V případě, že prodávající nezajistí nástup na opravu dodaného zboží ve lhůtě podle tohoto článku, je kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou a náklady na provedení opravy vyúčtovat prodávajícímu.
8. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na záruční opravu či v případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Právo na smluvní pokutu nevzniká po dobu, kdy prodávající bude plnit svou povinnost poskytnout kupujícímu náhradní zboží.

V.

Nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží (tj. ztráty, poškození, odcizení, zničení či znehodnocení) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo jeho dílčí části, je-li zboží přebíráno po částech, podpisem předávacího protokolu, a to v rozsahu v jakém bylo zboží převzato.
2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho předání.
3. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

VI.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.
4. Prodávající uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí kupující.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, případně bude uzavřena elektronicky.
6. Prodávající prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou svou součinnost při jejím výkonu.

7. Kupující je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
9. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na plnění předmětné smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Požadované technické parametry přístrojů.

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy doplní jím vyplněný svazek č.4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje pro přístroj, který je předmětem této smlouvy.

Příloha č. 2 – Předávací protokol.

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy předloží zadavatelem navrženou vyplněnou přílohu č. 2 kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Protokol o instruktáži obsluhy

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy předloží zadavatelem navrženou vyplněnou přílohu č. 3 kupní smlouvy

Příloha č. 4 Přehled doporučených pravidelných servisních činností a jejich četnost

(účastník zpracuje přehled stanovených pravidelných servisních činností po dobu životního cyklu parních sterilizátorů).

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu dodávky

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy předloží jím zpracovaný harmonogram postupu dodávky

V, dne

V, dne.....

.....

.....

Kupující

Prodávající

Předávací protokol
(pro každý přístroj samostatný předávací protokol)

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: e-mail:	Odběratel Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 Vyškov zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 zastoupená JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100 E-mail: horak@nemvy.cz
Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno, nainstalováno a předáno v souladu s Kupní smlouvou uzavřenou dne:

Zboží:

Č.pol	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Výr. číslo přístroje	Cena celkem včetně DPH
1	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků			
2	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků			

Dodané příslušenství:

Obecný název a typové označení	Výrobní číslo	Výrobce	Počet Ks	Cena/kus včetně DPH

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdrav. prostředcích a ZP in vitro je garantován po dobu (min. 24 měsíců) měsíců.

Zboží předal za dodavatele:

Zboží převzal za odběratele:

datum:

datum:

Jméno (hůlkovým písmem):

Jméno (hůlkovým písmem):.....
(primář přísl. oddělení)

podpis:

podpis:
Jméno (hůlkovým písmem):.....
vedoucí obch. oddělení

podpis:

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ doplní účastník žlutě podbarvené části protokolu.

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Protokol o instruktáži obsluhy v souladu se zákonem 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel tímto prohlašuje, že na zdravotnický prostředek,

Č.pol	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů	Výrobní číslo	Název výrobce
1	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků		1	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)
2	Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků		1	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

(dále jen zdravotnický prostředek)

který poskytl dne (bude doplněno v den zaškolení obsluhy) kupujícímu k provádění zdravotnických služeb, **provedl instruktáž** k předmětnému zdravotnickému prostředku v plném rozsahu ovládání. Instruktáž byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a s příslušným návodem k použití. Současně dodavatel seznámil s riziky spojenými s používáním uvedeného zdravotnického prostředku všechny osoby uvedené v tomto protokolu. V této souvislosti prodávající prohlašuje, že na instruktáž obsluhy předmětného zdravotnického prostředku má zabezpečeny osoby, které na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem poskytují dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání předmětného zdravotnického prostředku. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokáže i přiloženým potvrzením o oprávněnosti provádět instruktáž obsluhy v souladu s poučením výrobce za každého níže uvedeného zástupce dodavatele (viz Příloha č. 1. Níže uvedená)

Výše uvedenou instruktáží jsou pověřeny tyto osoby:

Jméno a příjmení	Obchodní a typový název přístroje	Název výrobce	Podpis osoby pověřené instruktáží
(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

(Určené osoby dodavatelem budou doplněny již do předložené nabídky)

Osoby, u kterých byla provedena instruktáž:

Jméno a příjmení	Datum provedené instruktáže	Podpis osoby, u které byla provedena instruktáž
(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

Svazek č. 3.3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ – Obchodní podmínky

(Osoby určené odběratelem budou doplněny v den zaškolení obsluhy)

Výše uvedené proškolené osoby jsou pověřené k provádění instruktáže dalších osob o zacházení se ZP a jeho používání ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění.

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Nemocnice Vyškov – Parní sterilizátory“ doplní účastník žlutě podbarvené části protokolu.

Příloha č. 1 – Potvrzení o oprávněnosti provádět instruktáž v souladu s poučením výrobce v souladu s ustanoveními zák. č. 375/2022 Sb.)

Pokyn pro účastníka: Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce doplní jím vyplněnou přílohu č.1 Protokolu o instruktáži obsluhy.

Konec: Svazku č. 3 Obchodní podmínky.

Minimální požadované technické parametry pro nákup parního sterilizátoru:

Předmět plnění	Počet ks	Typové označení a obchodní název přístroje
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků	1	

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x		
Výrobce	x		
využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů)	Ano		Podmínka
prokládací dvoudveřové provedení	Ano		Podmínka
celonerezová kvádřová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu			Podmínka
splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů			Podmínka
validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU	Ano		Podmínka
integrováný elektrický vyvíječ páry	Ano		Podmínka
motorické ovládání dveří sterilizační komory	Ano		Podmínka
vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou	Ano		Podmínka
intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ	Ano		Podmínka
systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů			Podmínka
USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech	Ano		Podmínka
zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) – požadujeme kompatibilitu se stávajícím transportním systémem BMT STERIVAP 6612-2 ED	Ano		Podmínka
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu	Ano		Podmínka
integrováný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji	Ano		Podmínka
software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní se sterilizační technikou	Ano		Podmínka

parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde je instalován současný přístroj a případné úpravy řeší dodavatel (celkový prostor na CS je 280 (v) x 570(š) x 135 (h) cm)	Ano		Podmínka
Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje:			
okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů	Ano		Podmínka
archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií	Ano		Podmínka
tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů	Ano		Podmínka
dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu	Ano		Podmínka
okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem	Uveďte		Informativní
ochrana dat systémem přístupových práv			Podmínka
ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru			
automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
nezávislý systém archivace dat	Ano		Podmínka
Ostatní požadavky			
nástup na servis do 24 hodin od nahlášení			
odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do 5-ti dní záruční doba 24 měsíců.			

Předmět plnění	Počet ks	Typové označení a obchodní název přístroje
Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků	1	

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x		
Výrobce	x		
využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů)	Ano		Podmínka
prokládací dvoudveřové provedení	Ano		Podmínka
celonerezová kvádřová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu			Podmínka
splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů			Podmínka
validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU	Ano		Podmínka
integrováný elektrický vyvíječ páry	Ano		Podmínka
motorické ovládání dveří sterilizační komory	Ano		Podmínka
vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou	Ano		Podmínka
intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ	Ano		Podmínka
systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů			Podmínka
USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech	Ano		Podmínka
zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) – požadujeme kompatibilitu se stávajícím transportním systémem BMT STERIVAP 6612-2 ED	Ano		Podmínka
sterilizace roztoků v uzavřených lahvích s řízeným chlazením a protitlakem vzduchu	Ano		Podmínka
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu	Ano		Podmínka
integrováný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji	Ano		Podmínka
software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní se sterilizační technikou	Ano		Podmínka
parní sterilizátor musí být rozměrově	Ano		Podmínka


kompatibilní s prostorem na CS, kde je instalován současný přístroj a případné úpravy řeší dodavatel (celkový prostor na CS je 280 (v) x 570(š) x 135 (h) cm)			
Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekčních automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje:			
okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů	Ano		Podmínka
archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií	Ano		Podmínka
tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů	Ano		Podmínka
dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu	Ano		Podmínka
okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem	Uveďte		Informativní
ochrana dat systémem přístupových práv			Podmínka
ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru			
automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu	Ano		Podmínka
nezávislý systém archivace dat	Ano		Podmínka
Ostatní požadavky			
nástup na servis do 24 hodin od nahlášení			
odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do 5-ti dní záruční doba 24 měsíců.			

V dne

.....

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

Dispoziční uspořádání oddělení
Centrální sterilizace v místě umístění
parních sterilizátorů

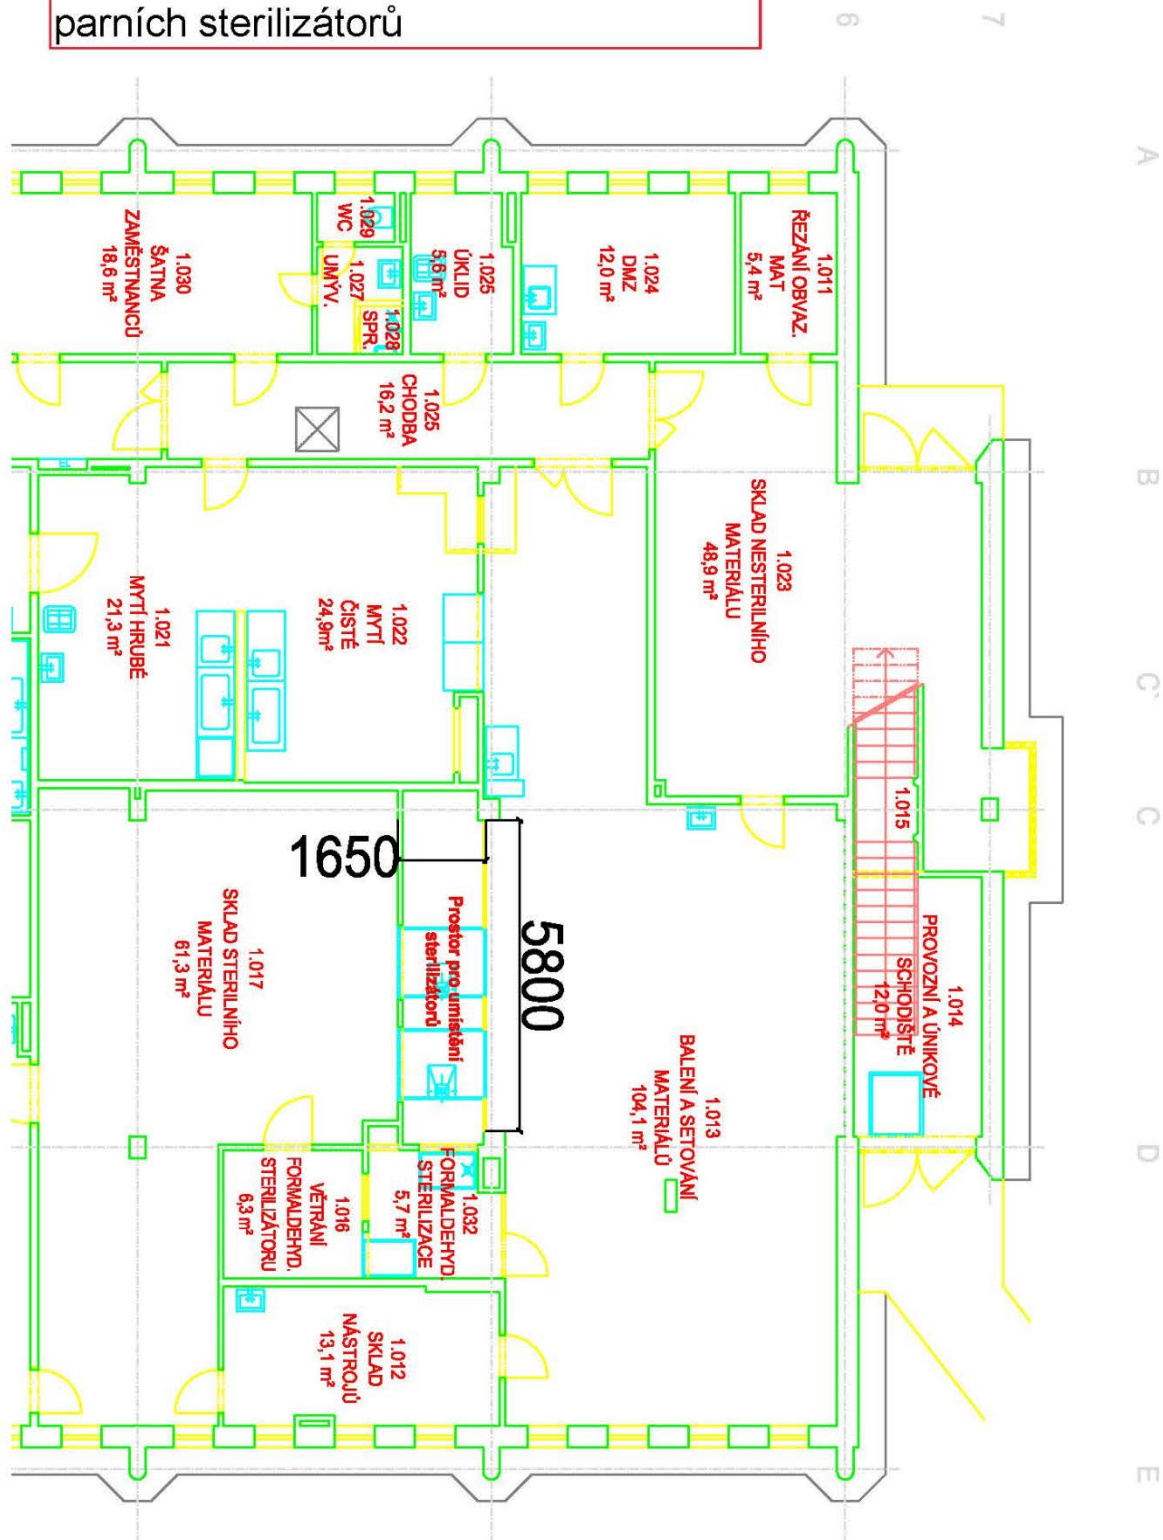



Výška – 2800 mm, hloubka – 1650 mm, šířka 5800 mm



Rozměr roštu na obrázku – 60 x 120 cm, na roštu zobrazen největší používaný kontejner rozměru 27 x 27 x 54 cm