

KUPNÍ SMLOUVA č. 01/05/2015

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky (smluvní strany):

- 1. Prodávající:** Promos spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsaná u: KOS Ostrava, Oddíl C, Vložka 1830
Zastoupení: Karel Mikuš, jednatel společnosti
IČO: 42866103
DIČ: CZ42866103
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka ve Val. Meziříčí
Č.účtu: 1763348309/0800
- 2. Kupující:** Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16, 664 95 Ivančice
Zapsána u: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka č. 1227
Zastoupení: Ing. Jaromír Hruběš, ředitel nemocnice
IČO: 00225827
DIČ: CZ00225827
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.účtu: 1937911/0100

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v příloze č. I této smlouvy (cenová nabídka číslo 119/05/2015/CN, bod 1.2.) včetně příslušenství (dále jen „zboží“), a to dle podmínek dále specifikovaných a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
2. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat za předpokladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo v obecně závazných předpisech a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Čl. II.

Kupní cena

1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za:
celkem bez 21% DPH: 238.300,00 Kč
21% DPH činí: 50.043,00 Kč
Celková částka vč. DPH: 288.343,00 Kč
(slovy dvěstaosmdesátosmtisícčtyřicetřetí korun).
3. Celková cena se rozumí včetně cla a DPH. Tato celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné pro splnění předmětu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy vč. dopravy do místa plnění.

4. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu a kupující dodávku potvrdí na dodacím listě.
5. Kupující zaplatí cenu za zboží na základě vystavené faktury a to nejpozději do 30 dnů, od jejího vystavení a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše.
6. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je kupující oprávněn fakturu vrátit.

Čl. III.

Doba a místo dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje předat zboží a zaškolit obsluhu nejpozději do 4 týdnů od podepsání kupní smlouvy oběma stranami.
2. Zboží bude dodáváno dopravními prostředky prodávajícího. Kupní cena zahrnuje i cenu za dopravu.
3. Za kupujícího je zboží oprávněn převzít Ing. Pavel Drozd, který je dále v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo zboží vykazuje zjevné vady, oprávněn tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání, nebo zboží znehodnocovaly, a to i přesto, že zboží je funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
4. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení faktury za dodané zboží.
5. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu, to je po zprovoznění zboží a zaškolení obsluhy.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od doby podpisu předávacího protokolu.

Čl. IV.

Doklady vztahující se ke zboží

1. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání zboží a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky podle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění, jako např. návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty a atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a technickými požadavky podle nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V.

Odpovědnost za vady

1. Délka záruční doby u zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
2. Záruční doba je přerušena na dobu, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží, a to technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy.


4. Zboží musí být dodáno nové, nepoužité, v originálním balení.
5. Prodávající se zavazuje v záruční době v pracovní dny k servisní reakci nejpozději do 48 hodin od prokazatelného oznámení poruchy kupujícím (faxem, elektronickou poštou) a uvést zboží do provozu nejpozději do dalších 48 hodin. Jestliže se prodávajícímu nepodaří zboží uvést do provozu ve výše zmíněné lhůtě, zavazuje se prodávající v záruční době zapůjčit kupujícímu náhradní zboží srovnatelných parametrů.

Čl. VI.**Smluvní pokuty**

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 15 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zásilky o více jak 15 dní, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty předmětu díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele (kupujícího) s úhradou ceny za dodávku není zhotovitel (prodávající) oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu dlužníka. Postoupení pohledávky je možné jen na základě písemného souhlasu dlužníka.

Čl. VII.**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.
3. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
4. Veškeré spory, které vzniknou mezi kupujícím a prodávajícím ohledně řešení právních vztahů, řešených touto smlouvou, budou na základě dohody účastníků smlouvy ve smyslu ustanovení § 89 OSŘ řešeny Krajským soudem v Brně.
5. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární zástupci kupujícího a prodávajícího.
6. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.

Ve Valašském Meziříčí, dne 21. 4. 2015V Ivančicích, dne 13. 4. 2015Karel Mikuš
jednatel společnosti

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Štorká 16

664 95 Ivančice

Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel nemocnice

IČO: 42866103
DIČ: CZ42866103
KOS Ostrava: oddíl C, vložka 1830

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Prim. MUDr. Zdeněk Gottvald
Široká 16
664 95 Ivančice

naše značka
1019/05/2015/CN

vyřizuje/linka
Ing. Tomáš Kořenek/724 450 932

Valašské Meziříčí
16.03.2015

Cenová nabídka

Vážený pane primáři,


dovoluji si Vám předložit následující cenovou nabídku na dodávku monitoru pro anesteziologii.

Předmět nabídky**1.1. Monitor M9 – anesteziologický monitor**

Monitor vitálních funkcí M9 s barevným displejem. Detekce pacemakeru, funkce přivolání sestry. Vhodný pro dospělé, děti i novorozence.

EKG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-Temp, puls

- 12,1" barevný TFT displej zobrazí až 8 křivek
- možnost prohlížení 120 vteřin křivky s plným popisem
- analýza EKG, arytmií s S-T segmentů
- detekce pacemakeru
- OxyCRG program pro neonatální pacienty
- vestavěná baterie s možností nabíjení
- možnost propojení s centrálou pomocí kabelů i bezdrátově
- funkce přivolání sestry

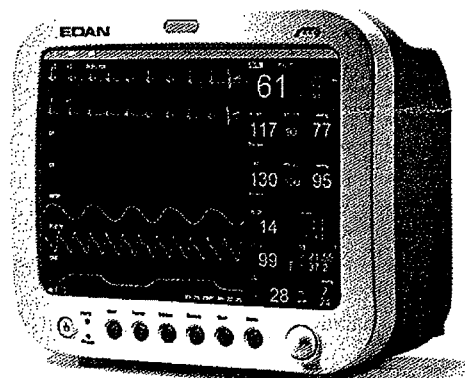

Technické parametry:

Rozměry: 322 x 285 x 150 mm

Hmotnost: 4,5 kg

Napájení: síťové nebo z baterie (výdrž cca 4,5 hod)

Tiskárna (volitelná): až 3 kanály, šíře tisku 50 mm

Dodávané příslušenství: EKG, SpO₂, Resp, NIBP, 2*Teplota, MultiGas - anestetické plyny/O₂ (Artema), 12 palc. TFT displej


Včetně měření O₂, včetně automatické identifikace plynu

Způsob měření kyslíku – elektrochemicky (galvanickým čidlem)

Název/typ	Cena/ks bez DPH (Kč)	DPH	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
Monitor M9 – anesteziologický monitor	169.000,00	21%	1	169.000,00
Celkem cena bez DPH:				169.000,00
DPH 21%				35.490,00

1.2. Monitor vitálních funkcí EDAN M70 – anesteziologický monitor

- 12.1" palcový, barevný, TFT-LCD displej
- Pasivní chlazení (bez větráku)
- Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti elektrochirurgickému rušení
- Ochrana proti defibrilaci a synchronizace defibrilace
- iSEAP EKG algoritmus optimalizovaný pro detekci arytmií, detekci kardiostimulátoru, a měření tepové frekvence
- iMAT SpO2 algoritmus s vynikající odolností proti pohybovým artefaktům a nízké perfúzi
- iCUPS NIBP algoritmus optimalizovaný pro kardiaky, pacienty s hypertenzí a novorozence
- iCARB algoritmus s inteligentní technologií identifikace CO2 křivky
- VGA/DVI výstup a analogový výstup
- Podpora čtečky čárového kódu
- Vestavěná dobíjecí Li-ion baterie
- Obousměrná komunikace s MFM-CMS centrálním monitorem
- Funkce přivolání sestry
- Funkce zobrazení jiného lůžka v síti
- USB/SD uložení dat
- Podpora HL7 přes XML soubory
- LAN/Wi-Fi konektivita s podporou DHCP
- Volitelně vestavěný Wi-Fi modul
- Noční režim
- Flexibilní uchycení na stojan či držák na stěnu

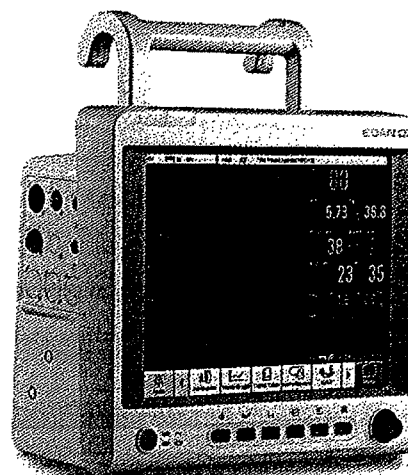

K této nabídce je nutné připočítat **MultiGas (Phase-In Masimo)** modul.

ISA™ Sidestream Analyzers, ISA OR+, CAT.NO.800401 (CO2,O2,N2O,5AA,AAID Auto identifikace plynu) s jedním kusem (Nomoline s luer lock konektorem)

Včetně měření O₂, včetně automatické identifikace plynu

Způsob měření kyslíku – paramagneticky

Název/typ	Cena/ks bez DPH (Kč)	DPH	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
Monitor vitálních funkcí EDAN M70	41.400,00	21%	1	41.400,00
ISA™ Sidestream Analyzers, ISA OR+	196.900,00	21%	1	196.900,00
Celkem cena bez DPH				238.300,00
DPH 21%				50.043,00


1.3. Monitor vitálních funkcí EDAN M80 – anesteziologický monitor

Víceúčelový patientský monitor sleduje parametry jako EKG, RESP, SpO₂, NIBP, Teplota, IBP, CO₂. Je vhodný pro dospělé, dětské i neonatální pacienty. Všechny monitory vitálních funkcí EDAN mají nainstalován český jazyk.

- velký přehledný 15" barevný TFT displej
- zobrazení až 13 křivek
- základní parametry: EKG (3 nebo 5 kanálů), respirace, NIBP, SpO₂, 2x teplota
- 120 hodin grafických a tabulkových trendů u všech parametrů
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy
- možnost monitorování pacientů všech věkových kategorií
- vestavěná lithiová baterie – až 4,5 hod provozu
- rozměry (š×h×v): 370×170×320 mm
- hmotnost: 7 kg

Volitelné rozšíření

- Nellcor OxiMax SpO₂,
- 4-IBP modul,
- 12svodové EKG
- EtCO₂ Respironic,
- CO₂,
- Multi-gas,
- termocitlivá tiskárna
- možnost dotykového displeje

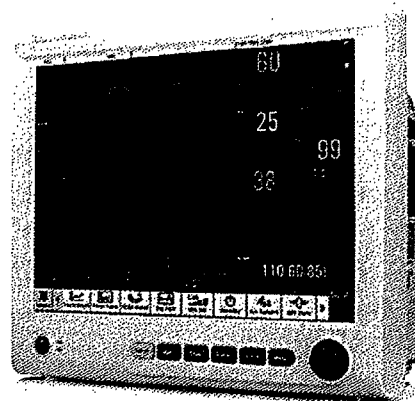

Součástí dodávky monitorů vitálních funkcí jsou čidla a příslušenství pro moduly EKG, NIBP, SpO₂, teploty.

K této nabídce je nutné připočítat MultiGas (Phase-In Masimo) modul.

ISA™ Sidestream Analyzers, ISA OR+, CAT.NO.800401 (CO₂, O₂, N₂O, 5AA, AAID Auto identifikace plynu) s jedním kusem (Nomoline s luer lock konektorem)

Včetně měření O₂, včetně automatické identifikace plynu

Způsob měření kyslíku – paramagnetický

Název/typ	Cena/ks bez DPH (Kč)	DPH	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)
Monitor vitálních funkcí EDAN M80	55.000,00	21%	1	55.000,00
ISA™ Sidestream Analyzers, ISA OR+	196.900,00	21%	1	196.900,00
Celkem cena bez DPH				251.900,00
DPH 21%				52.899,00

2. Platební podmínky

Platba dle dohody obou smluvních stran.

3. Termín dodání

3-5 týdnů od podpisu kupní smlouvy, obdržení závazné objednávky.

4. Záruční doba, podmínky pro poskytování záručního a pozáručního servisu

- | | |
|-----------------|---|
| a) záruční doba | 24 měsíců na přístroj ode dne předání uživateli a zaškolení
6 měsíců na spotřební materiál |
| b) místo: | PROMOS spol. s r.o., projekce, montáže, servis
Nová 177
757 01 Valašské Meziříčí |

Platnost cenové nabídky: do 30.04. 2015

Děkuji Vám za projevený zájem a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kořenek
obchodní zástupce